



2023年4月4日

講演タイトル

「生活習慣改善による感染症の予防」

認定特定非営利活動法人

バイオメディカルサイエンス研究会

瀬島俊介

感染症対策 新・生活習慣普及促進研究会

座長：賀来満夫 東北大学名誉教授


副座長：瀬島俊介 NPO法人バイオメディカルサイエンス研究会理事長
一般社団法人レジリエンスジャパン推進協議会

- | | | |
|---|--------------|-------------|
| 1 | 免疫ケアと食WG | 主査：賀来満夫先生 |
| 2 | マウスウォッシュWG | 主査：阪井丘芳先生 |
| 3 | 新清掃習慣 床対策WG | 主査：瀬島俊介 |
| 4 | 「水洗い」「水拭き」WG | 主査：松岡キーロン先生 |
| 5 | マスター制度構築WG | 主査：井手口直子先生 |
| 6 | 店舗評価制度構築WG | 主査：瀬島俊介 |

- **コロナ感染防止に床清掃が注目されている**

CDC（米国感染症予防センター）による
武漢のコロナ患者病院調査

PCR検査検体あたりコロナウイルス数

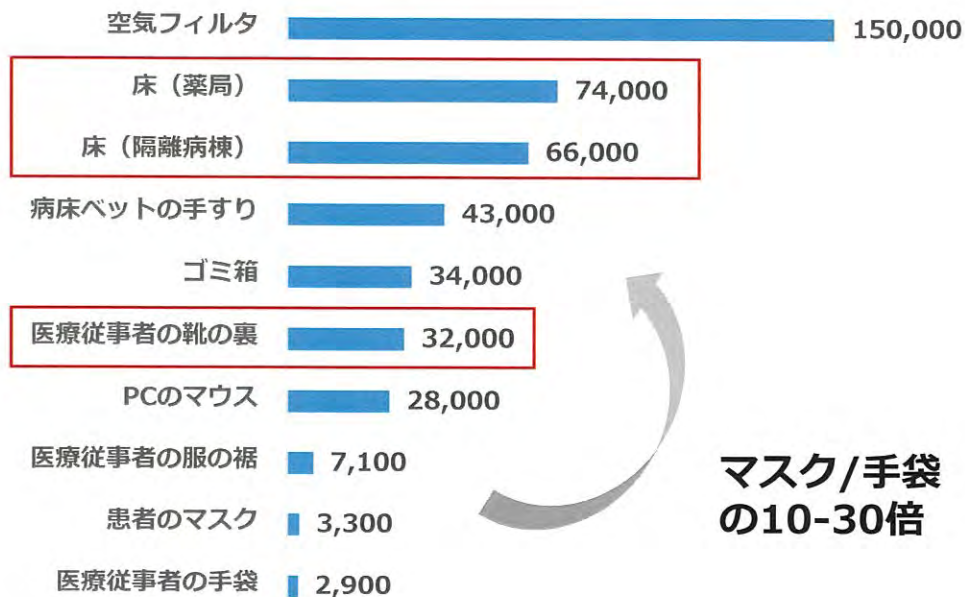

マスク/手袋
の10-30倍

ダクトの
HEPAフィルタに集積





出所) https://wwwnc.cdc.gov/eid/article/26/7/20-0885_articl

GMP3-S

1.5m オートサーキュレーター



設置推奨位置

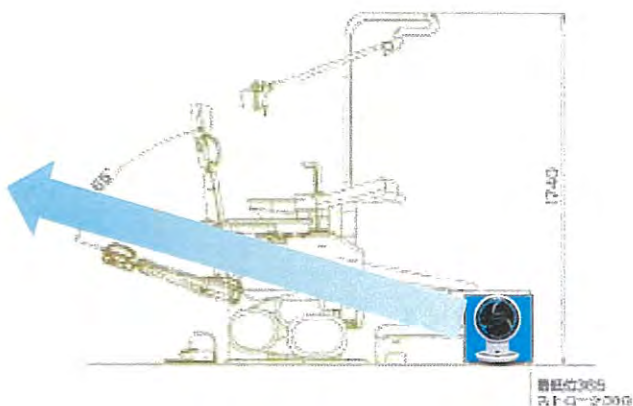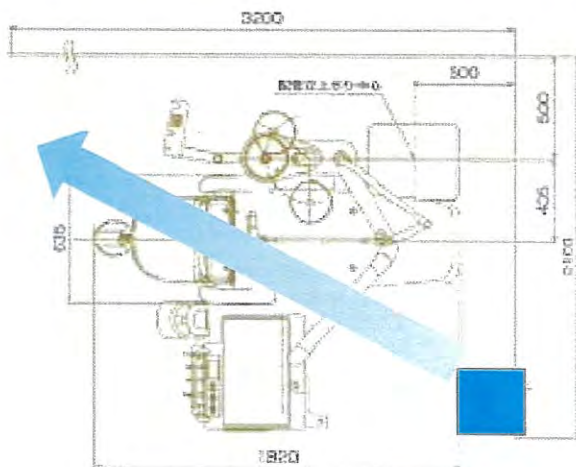

サーキュレーターアイ DC JET ~24畳 KCF-SDC151T ホワイト

省エネ性が高いDCモーター搭載、より強力で静音性も高まったDCジェットサーキュレーターです。特殊形状スパイラルグリル・新ボール型フォルムを採用。ジェット気流効果により、コンパクトでもパワフルな風が届きま...

もっと詳しく

JAN	取扱説明書	主要素材						
4967576396417	PDF (6.3MB)	ABS樹脂、ポリプロピレン、POM、鉄、アルミ						
商品サイズ (mm・kg)		パッケージサイズ (mm)		ケース	ケース			
幅	奥行	高さ	重量	幅	奥行	高さ	容積	入数
210	210	290	1.3	254	254	334	107.1L	4台

基本仕様


電源	AC100~240V (50/60Hz共用) (ACアダプタ付)	消費電力	25W
風量切替	10段階	角度調整	左右/60、90、120°・上下/60°
過熱保護	24畳	羽根サイズ	15cm
入タイマー	2、4、8時間	切タイマー	2、4、8時間
コードの長さ	約1.8m	保証期間	お買い上げ日より1年間



エアマネとは

⇒**空気の見える化を通じて、店舗・空間の安心を管理**

空気の基準をつくったうえで、正しくアクションを実施。
モニタリングにより空気を見える化し、対外的に発信

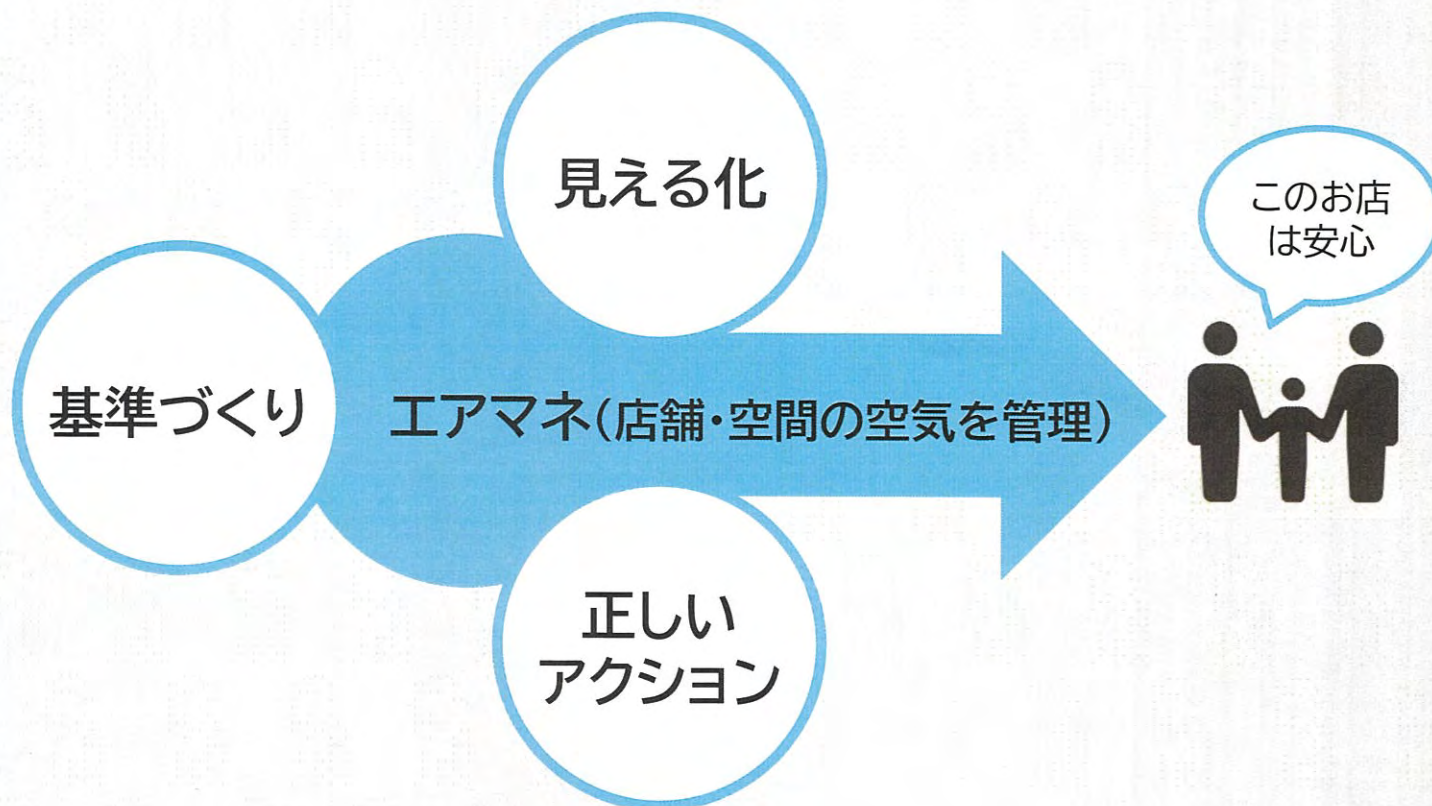

基準をつくる

⇒基準を考えるうえで、まずはカテゴリーの整理に着手

各事業者・空間に応じて衛生に対する意識が異なるため、
カテゴリーに応じた考え方が必要

カテゴリー1
(そもそも衛生意識が高い)

・病院・介護・学校
・保健所・etc.

・持ち込まない対策の徹底
・意識の徹底
・共通認識 指揮命令系統

カテゴリー2
(管理者が居る=管理が容易)

・公共施設・駅・図書館
・オフィス・工場・ホテル・etc.

・清掃の重要性
・人の出入り制限の可否
・BCP的観点も必要

カテゴリー3
(管理者が居ない=管理が困難)

・飲食店・カラオケ・スーパー
・コンビニ・デパート・etc.

・不特定多数の人
・行動管理できない
・清掃の徹底が難

空間衛生管理の難易度

ご清聴ありがとうございました。